

この電子添文をよく読んでから使用してください。
また、最新の電子添文を必ず確認してください。

認証番号 227AAEZ00031000

体外診断用医薬品

** 2023年 6月改訂(第 8版)

* 2022年11月改訂(第 7版)

Code No. 476-11731
473-13201

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメントキット

アキュラシード NT-proBNP

(化学発光酵素免疫測定法)

〔一般的な注意〕

- (1) 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
- * (2) この電子添文に記載された使用方法に従って使用してください。記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証しかねます。
- * (3) 測定機器は添付文書等および取扱説明書に従い、適切な条件下で使用してください。なお、詳細については、機器メーカーに問い合わせてください。
- (4) 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断してください。

〔形状・構造等(キットの構成)〕

試薬カートリッジ

- (1) 抗体結合粒子 (R0)
(抗 NT-proBNP ポリクローナル抗体(ヒツジ)結合粒子)
- (2) 免疫反应用緩衝液 (R1)
- (3) 酵素標識抗体 (R2)
(ペルオキシダーゼ標識抗 NT-proBNP ポリクローナル抗体(ヒツジ))
- (4) 基質液 (R3) (ルミノール)
- (5) 過酸化水素液 (R4) (過酸化水素)

〔使用目的〕

血清又は血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント (NT-proBNP) の測定

〔測定原理〕

本法は粒子を固相とした化学発光酵素免疫測定法に基づきます。
抗 NT-proBNP ポリクローナル抗体(ヒツジ)結合粒子に、検体中の NT-proBNP を反応させ、次いでペルオキシダーゼ標識抗 NT-proBNP ポリクローナル抗体(ヒツジ)を反応させると、「抗体結合粒子-NT-proBNP-酵素標識抗体」の複合体が形成されます。抗体結合粒子に結合した酵素の量は NT-proBNP 濃度に比例しますので、その酵素活性を化学発光試薬(ルミノール、過酸化水素)を用いて測定することにより、あらかじめ既知濃度の標準液を用いて作成した検量線から検体中の NT-proBNP 濃度を求めることができます。

〔操作上の注意〕

<測定試料の性質、採取法>

- (1) 検体は血清又は血漿を使用してください。
- (2) 採取後の検体は速やかに測定してください。
- (3) 検体を保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- (4) 凍結検体の使用に際しては素早く融解し、すぐに測定を行ってください。再測定が予想される場合はあらかじめ必要量を再測定用として小分けして凍結保存するなどし、凍結融解の繰り返しは避けてください。
- (5) 抗凝固剤のヘパリン、クエン酸塩、シュウ酸塩、EDTA および解糖阻抑制剤のフツ化ナトリウムは通常使用量では測定値に影響を与えません。
- * (6) 採血管の使用方法は、採血管製造販売元の添付文書等に従ってください。
- (7) 血清を試料とする場合は、血餅の凝固が十分であることを目視にて確認してから遠心分離を行ってください。採血後の転倒混和や遠心分離前の静置が不十分な場合は、血餅の凝固が不十分となり正しい測定結果が得られない場合があります。なお、遠心分離前の適切な静置時間は、検体の背景(疾患や治療等)により異なりますので注意してください。
- (8) 沈殿物のある検体は、使用前に遠心分離を行い除去してから使用してください。
- (9) 試料中にフィブリンや赤血球、白血球、微小な浮遊物などを認めた場合は、遠心分離をしたりサンプルカップに分取したりするなどして、必ず取り除いてから測定に使用してください。なお、目視できる不溶物が認められない場合でも、測定値に影響を与える物質が試料中に存在することがあります。
- (10) 測定の前に、検体中の気泡の有無を確認してください。気泡がある場合は除いてください。

<妨害物質・妨害薬剤>

- (1) 乳びはホルマジン濁度として 1400 まで、ビリルビンは 18mg/dL まで、ヘモグロビンは 450mg/dL まで測定値に影響は認められませんでした。
- (2) リウマチ因子が高濃度で存在する場合は、測定値に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- (3) 一般的な治療薬や心臓疾患へ用いる治療薬では、測定値に影響を与えません。

<その他>

- (1) 装置での測定には、指定のサンプリングチップおよびサンプルカップを使用してください。
- (2) キャリブレーションの有効期間を超えた場合には、アキュラシード NT-proBNP 用キャリブレーターセット(別売品)を用いて再度キャリブレーションを行ってください。
- (3) 検体の測定値が測定範囲を超える場合は、別売品のアキュラシード 検体希釈液カートリッジまたはアキュラシード 検体希釈液セットを使用の上、再測定してください。

〔用法・用量(操作方法)〕

<試薬の調製方法>

試薬カートリッジ: そのまま使用してください。

<必要な器具・器材・試料等>

自動分析装置: 自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®

検量線用試料: アキュラシード NT-proBNP 用キャリブレーターセット(別売品)

使用に際しては、アキュラシード NT-proBNP 用キャリブレーターセットの現品説明書を参照してください。

基本検量線シート(付属品)

アキュラシード カーディオマルチコントロールセット(別売品)

アキュラシード B/F 分離液(別売品)

アキュラシード サンプリングチップ(別売品)

アキュラシード 検体希釈液セット(別売品)

アキュラシード 検体希釈液カートリッジ(別売品)

マイクロピペットおよびサンプルカップ


<測定法>

測定操作の詳細は自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®の取扱説明書を参照してください。

操作法

- (1) 試薬カセットの QR コード*を QR コード読取部に読み込ませます。
- (2) 読み込みが完了した試薬カセットのキャップを外し、試薬庫にセットします(この操作により項目名等の試薬情報管理が自動的に行われます)。
- (3) 「基本検量線」メニューを選択し、付属の「基本検量線シート」の QR コードを QR コード読取部に読み込ませます。
(基本検量線の読み込みはロット毎に行います)
- (4) 検量線の補正は装置のキャリブレーション実施方法に従って行います。
- (5) コントロール、検体を装置の測定方法に従って準備してください。
- (6) 開始ボタンを押し、測定を開始します。
- (7) 測定結果はプリントアウトすることもできます。
(自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®ではプリンターはオプションです)
*QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

プロトコール

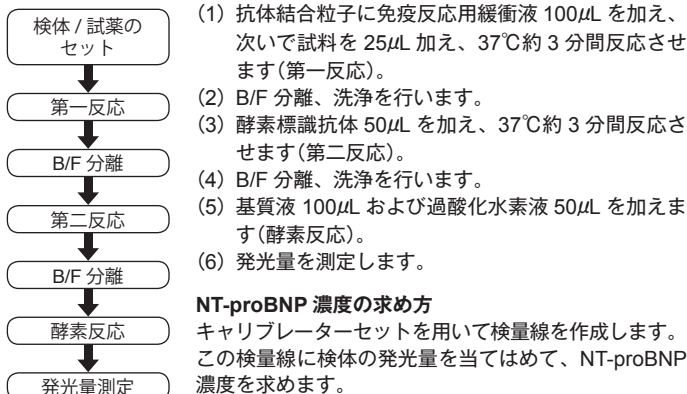

〔測定結果の判定法〕

参考正常値: 54.5pg/mL 以下⁽¹⁾

心不全除外対象のカットオフ値: 125pg/mL⁽²⁾

<判定上の注意>

- (1) 参考正常値は、測定条件や検体によって異なる場合がありますので、各施設で設定することが望まれます。
- (2) 検体中に非特異反応物質(異好性抗体等)が存在する場合は、正しい測定結果が得られないことがありますので、測定結果の判定は他の検査や臨床症状等を考慮して担当医師が総合的に判断してください。
- (3) BNP は、前駆体ホルモンである proBNP が分解して生じる生理活性を有するペプチドで、この時同時に生理活性を有しない NT-proBNP が生じます。血中半減期は BNP に比べて proBNP および NT-proBNP の方が長いことが知られています。(6)
- (4) NT-proBNP は腎によりクリアランスされますので、腎疾患患者の NT-proBNP 値の解釈には注意が必要です。(6)

〔性能〕

<性能>

- (1) 感度
0pg/mL の標準 NT-proBNP を試料として操作した場合の発光量を A とし、1000pg/mL の標準 NT-proBNP を試料として操作した場合の発光量を B としたとき、発光量比 B/A の値は 50 以上です。
- (2) 正確性
既知濃度の管理検体を測定したとき、測定値(pg/mL)は既知濃度±20%以内にありまます。
- (3) 同時再現性
同一検体を 5 回同時に測定したとき、測定値(pg/mL)の変動係数(CV)は 10%以下です。
- (4) 測定範囲
本キットによる NT-proBNP の測定範囲は 10~35000pg/mL です。

<相関性試験成績>

スフィアライトとの相関

検体	血清	血漿
相関係数	r = 0.992 (n=56)	r = 0.973 (n=58)
回帰式	y = 1.052 x - 1.0	y = 1.070 x + 1.0
y	本品 (pg/mL)	本品 (pg/mL)
x	スフィアライト proBNP (pg/mL)	スフィアライト proBNP (pg/mL)

ミュータスとの相関

検体	血清	血漿
相関係数	r = 0.991 (n=56)	r = 0.988 (n=58)
回帰式	y = 0.993 x + 0.1	y = 0.994 x + 7.5
y	本品 (pg/mL)	本品 (pg/mL)
x	ミュータスカーディオ NT-proBNP (pg/mL)	ミュータスカーディオ NT-proBNP (pg/mL)

<較正用の基準物質(標準物質)>

社内標準品

〔使用上又は取扱い上の注意〕

<取扱い上(危険防止)の注意>

- (1) 試薬が誤って口や目に入ったり、皮膚に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- (2) 検体はウイルス等の感染の危険性を考慮して取扱ってください。

<使用上の注意>

- (1) 試薬は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (2) 誤って凍結させた試薬は使用しないでください。
- (3) 基本検量線シートは本品の使用が終了するまで保管してください。
- (4) 試薬カセット中の試薬カートリッジは残量管理をしているので、装置以外での試薬カートリッジの抜き取りは行わないでください。また、同一ロットのものであっても試薬カセット中に追加しないでください。
- (5) 装置から抜き取った試薬カセットを、他の装置で使用しないでください。試薬残量が正しく認識されません。
- (6) 試薬カセットを装置から取り出して保存する場合には、直ちにカセットキャップをして天地確認の上、2~10℃で保存してください。カセットキャップをせず保存した場合や、2~10℃の範囲外で保存されていた場合は、この試薬カセットを使用しないでください。
- (7) 試薬カセットに外から強い衝撃を与えないでください。
- (8) 試薬カセットに破損がある場合は使用しないでください。
- (9) 本品中の容器、付属品は他の目的に転用しないでください。

<廃棄上の注意>

- (1) 検体と接触した試薬および試薬容器等は、感染の危険性がありますので、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20 分以上)による滅菌処理を行ってから廃棄してください。

- ** (2) 廃棄に際しては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、水質汚濁防止法等の規定に従って適切に処理してください。基質液(R3)中にほう素として 157mg/L を含有しています。
- (3) 抗体結合粒子、免疫反応用緩衝液および酵素標識抗体は、保存剤としてアジ化ナトリウムを約 0.08%含有しています。アジ化ナトリウムは、銅や鉛などの重金属と結合してアジ化物を形成します。重金属のアジ化物は乾燥状態で衝撃により爆発する性質がありますので、排水後は排水管に残留しないように十分の水で洗い流してください。
- (4) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm)、グルタルアルデヒド(2%)等の消毒液を用いてふき取ってください。

〔貯蔵方法・有効期間〕

<貯蔵方法> 2~10℃保存

<有効期間> 製造後 1 年間

〔包装単位〕

コード番号	品名	包装
476-11731	アキュラシード NT-proBNP	60 回用 (試薬カセット(20 試薬カートリッジ)×3)
473-13201	アキュラシード NT-proBNP	180 回用 (試薬カセット(20 試薬カートリッジ)×9)

<別売>

コード番号	品名	包装
478-11811	アキュラシード NT-proBNP 用 キャリブレーションセット	1mL×2×2 種
474-12011	アキュラシード カーディオマルチ コントロールセット	2mL×2×2 種
470-11631	アキュラシード B/F 分離液	10L
475-92641	アキュラシード サンプリングチップ	70 本×30
473-11621	アキュラシード 検体希釈液セット	50mL×2
477-11641	アキュラシード 検体希釈液カートリッジ	60 回用

〔主要文献〕

- (1) Seino Y., et al : The European Journal of Heart Failure, 6, 295(2004)
- (2) Al-Barjas M., et al : The European Journal of Heart Failure Supplements, 3(1), 51(2004)
- (3) Mair J., et al : Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 39(7), 571(2001)
- (4) Sudoh T., et al : Nature, 332, 78(1988)
- (5) Sudoh T., et al : Biochemical and Biophysical Research Communication, 168(2), 863(1990)
- (6) 清野精彦 他 : BIO Clinica, 19(6), 47(2004)

〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社

臨床検査薬 カスタマーサポートセンター

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2 丁目 4 番 1 号

TEL : (03)3270-9134 (ダイヤルイン)

三洋化成工業株式会社

バイオ・メディカル事業本部

〒605-0995 京都市東山区一橋野本町 11 番地の 1

TEL : (075)541-6317 (ダイヤルイン)

本製品の製造販売につきロシュ社からライセンスされた日本特許番号
特許 JP 3375630、JP 3987284

製造販売元

三洋化成工業株式会社

京都市東山区本町 11 丁目 7 2 1 番地

TEL (075) 541 - 6318 (ダイヤルイン)

販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 2 号